


CODIGO 74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

DESCRIPCION: SISTEMA ELECTROLISIS EXPERT

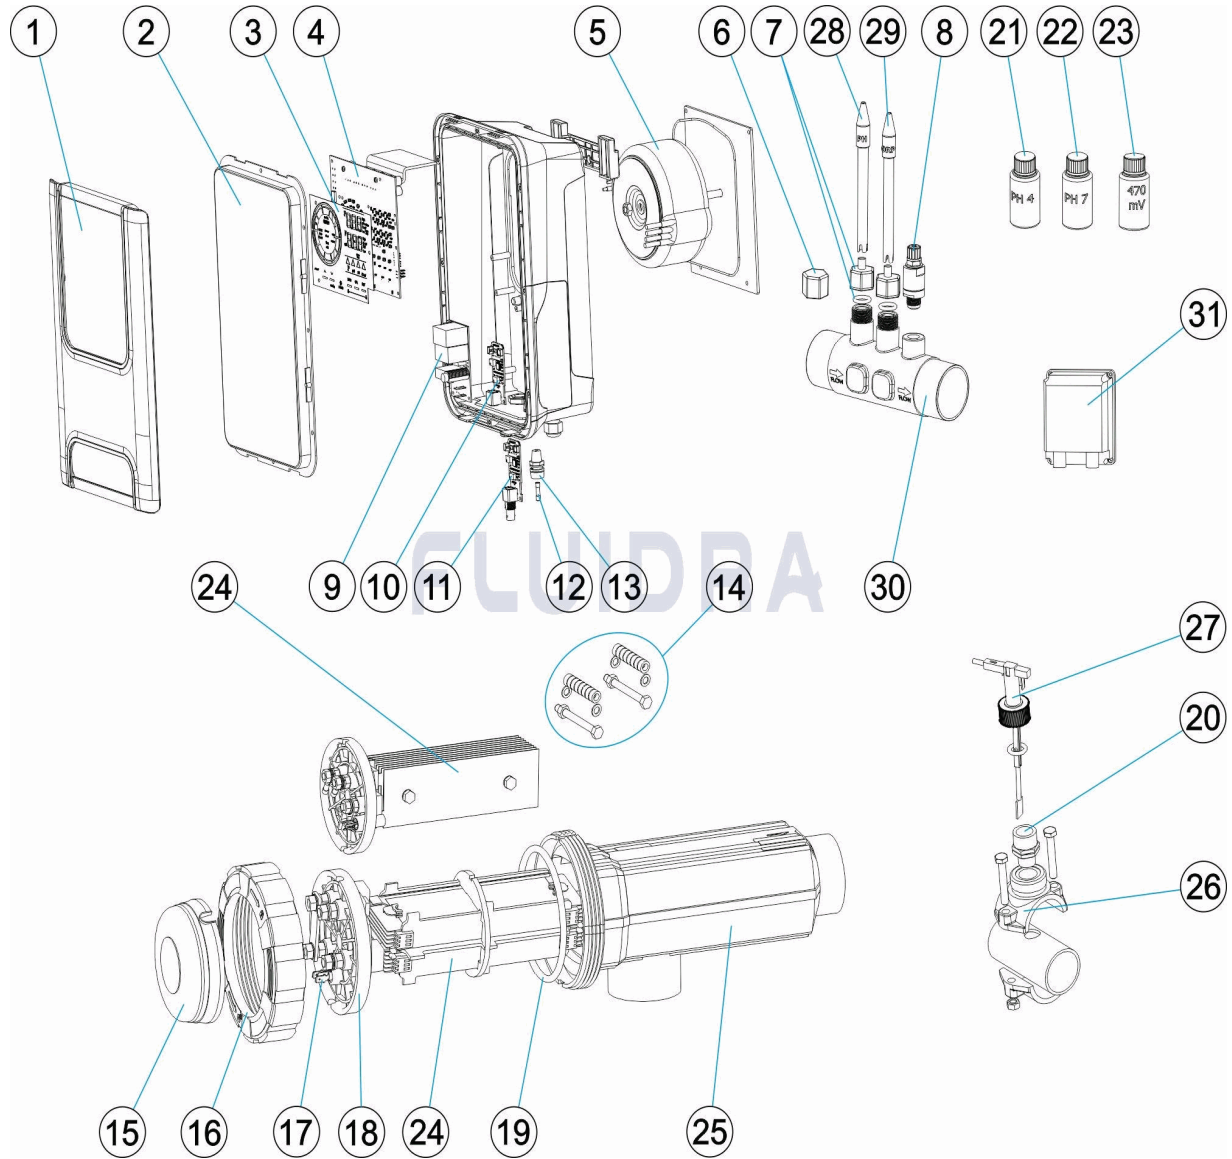

ESPAÑOL

POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	POS	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	4408040526	MARCO FRONTAL		8	* 4408040068	VALVULA INYECCION PH-MINUS 3/8"	
2	4408060156	CARATULA FRONTAL NEGRA		9	4408040292	PBA FILTRO CONTROL	
3	4408040525	TECLADO EXPERT		10	* 4408040365	PBA CONTROL ORP	
4	* 4408040287	TARJETA POTENCIA SMN-7		11	* 4408040293	PBA CONTROL PH	
4	* 4408040288	TARJETA POTENCIA SMN-12		12	* 4408041112	FUSIBLE 1A	
4	* 4408040289	TARJETA POTENCIA SMN-21		12	* 4408041113	FUSIBLE 2A	
4	* 4408040290	TARJETA POTENCIA SMN-30		12	* 4408041114	FUSIBLE 3A	
4	* 4408040291	TARJETA POTENCIA SMN-40		12	* 4408041204	FUSIBLE 4A	
5	* 4408040265	TRANSFORMADOR 110VA		13	4408040523	PORTAFUSIBLE 5X20 CHASIS	
5	* 4408040266	TRANSFORMADOR 190VA		14	* 4408040073	KIT ANCLAJE ELECTRODOS DOMESTICO	
5	* 4408040267	TRANSFORMADOR 230VA		15	4408040527	PROTECTOR CONTACTOS	
5	* 4408040268	TRANSFORMADOR 340VA		16	4408040271	ANILLO ROSCADO CELULA	

*** NOTA OBSERVACIONES**

CODIGO **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,**
74193, 74194, 74195, 74196, 74197

DESCRIPCION: SISTEMA ELECTROLISIS EXPERT

5	* 4408040269	TRANSFORMADOR 440VA	17	4408060158	SENSOR DE TEMPERATURA
6	* 4408060121	TAPON NEGRO OBTURADOR + JUNTA	18	* 4408040076	SOPORTE ELECTRODO ABIERTO TC
7	* 4408060116	COLLARIN SENSOR + JUNTA	18	* 4408040272	SOPORTE ELECTRODO BIP
19	4408040510	JUNTA VASO EPDM.	24	* R-065	RECAMBIO ELECTRODO DT-40
20	4408060059	REDUCCION M-M ¾ ½"	25	57655	CELULA PORTA ELECTRODOS
21	* 60632	TAMPON PH 4,0 50 ML. (ROJO)	26	* 11440	COLLARIN 50 M/M. ½"
22	* 60618	TAMPON PH 7,0 50 M/L. (VERDE)	26	* 28679	COLLARIN 63 M/M. ½"
23	* 60633	SOLUCION CALIBRACION 470MV.	27	71124	FLUJOSTATO
24	* R-061	RECAMBIO ELECTRODO DT-7	28	* R0819800	SONDA PH P19 CON 3 M DE CABLE BNC
24	* R-062	RECAMBIO ELECTRODO DT-10/12	29	* R0819900	SONDA REDOX P19 CON 3 M DE CABLE BNC
24	* R-063	RECAMBIO ELECTRODO DT-21	30	* 74493	PORTASONDAS
24	* R-064	RECAMBIO ELECTRODO DT-30	31	* 70054	BOMBA PERISTALTICA 1,5-1,5 230V

CODIGO **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197**


DESCRIPCION: SISTEMA ELECTROLISIS EXPERT

OBSERVACIONES

POS	CODIGO	OBSERVACIONES
4	* 4408040287	PARA: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	PARA: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	PARA: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	PARA: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	PARA: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	PARA: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	PARA: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	PARA: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	PARA: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	PARA: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	PARA: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	PARA: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	PARA: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	PARA: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	PARA: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	PARA: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	PARA: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	PARA: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	PARA: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	PARA: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	PARA: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	PARA: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	PARA: Ø50
26	* 28679	PARA: Ø63
28	* R0819800	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIPTION: **SYSTÈME ÉLECTROLYSE EXPERT**

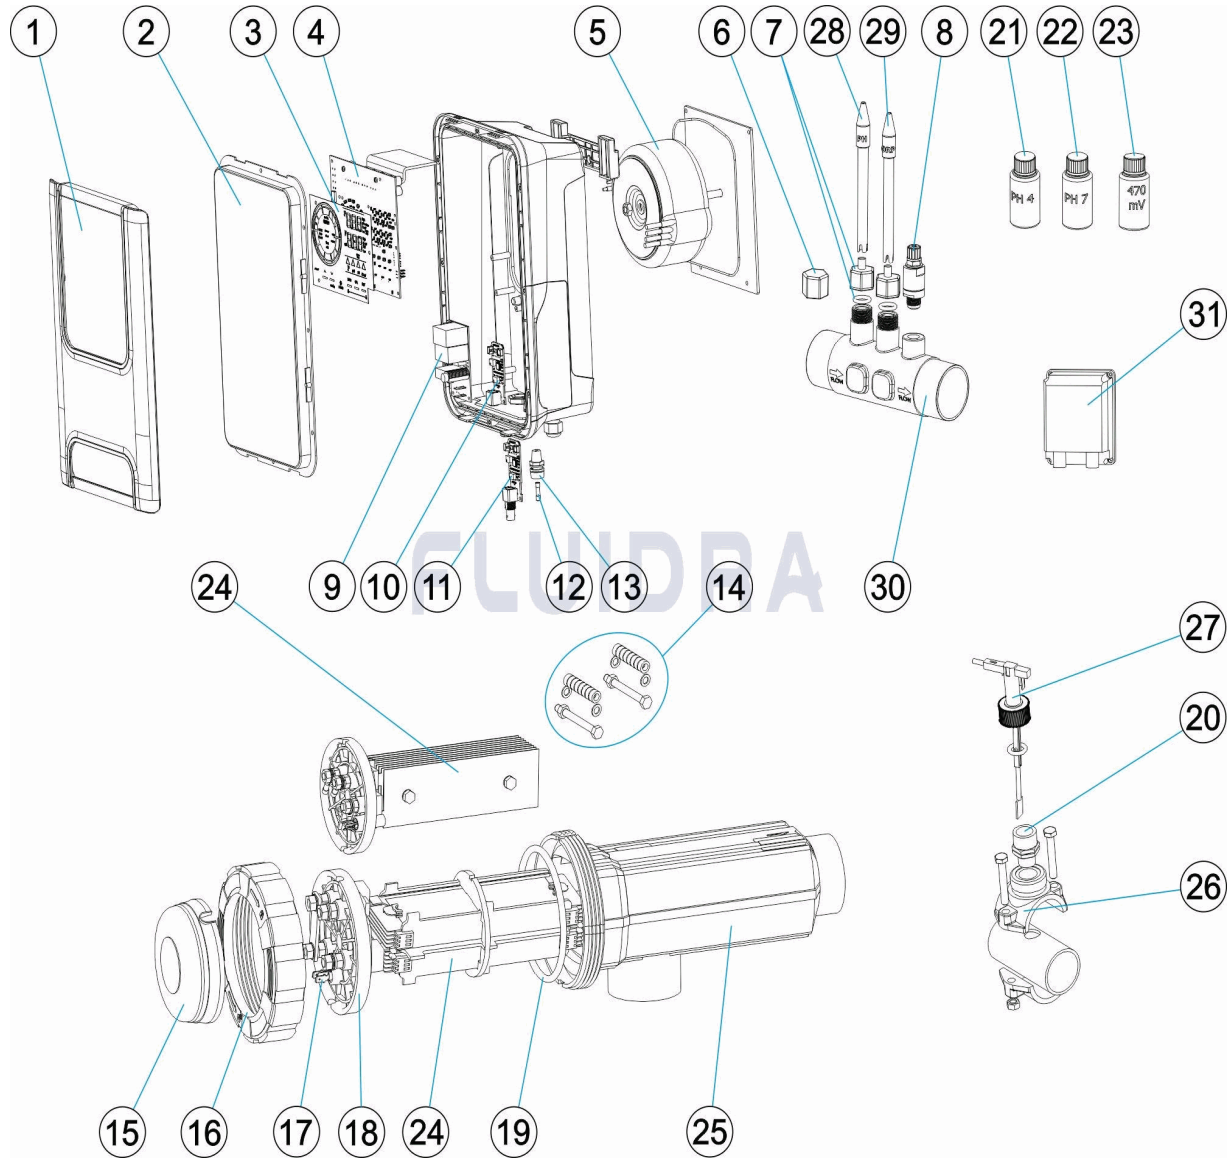

FRANCAIS

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITE
1	4408040526	CADRE FRONTAL		8	* 4408040068	VANNE INJECTION PH-MINUS 3/8"	
2	4408060156	COUVERCLE AVANT NOIR		9	4408040292	PBA FILTRE CONTRÔLE	
3	4408040525	CLAVIER EXPERT		10	* 4408040365	PBA CONTRÔLE ORP	
4	* 4408040287	CARTE PUISSANCE SMN-7		11	* 4408040293	PBA CONTRÔLE PH	
4	* 4408040288	CARTE PUISSANCE SMN-12		12	* 4408041112	FUSIBLE 1A	
4	* 4408040289	CARTE PUISSANCE SMN-21		12	* 4408041113	FUSIBLE 2A	
4	* 4408040290	CARTE PUISSANCE SMN-30		12	* 4408041114	FUSIBLE 3A	
4	* 4408040291	CARTE PUISSANCE SMN-40		12	* 4408041204	FUSIBLE 4A	
5	* 4408040265	TRANSFORMATEUR PUISSANCE 110VA		13	4408040523	PORTE-FUSIBLES 5X20 CHASSIS	
5	* 4408040266	TRANSFORMATEUR PUISSANCE 190VA		14	* 4408040073	KIT ANCRAGE ÉLECTRODES KIT	
5	* 4408040267	TRANSFORMATEUR PUISSANCE 230VA		15	4408040527	PROTECTEUR CONTACTS	
5	* 4408040268	TRANSFORMATEUR PUISSANCE 340VA		16	4408040271	ANNEAU FILETÉ CELLULE	

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIPTION: **SYSTÈME ÉLECTROLYSE EXPERT**

5	* 4408040269	TRANSFORMATEUR PUISSANCE 440VA	17	4408060158	CAPTEUR TEMPÉRATURE
6	* 4408060121	COUVERCLE NOIR DE FERMENTURE + JO	18	* 4408040076	ÉLECTRODES DE RECHANGE SUPPORT O
7	* 4408060116	BAGUE PORTE-SONDE + JOINT	18	* 4408040272	ÉLECTRODES DE RECHANGE SUPPORT BI
19	4408040510	JOINT VASE EPDM	24	* R-065	RECHANGE ÉLECTRODE DT-40
20	4408060059	REDUCTION MM ¼ ½" SONDE SUR COLLIE	25	57655	CELLULE PORTE-ÉLECTRODE
21	* 60632	TAMPON PH 4,0 50 ML. (ROUGE)	26	* 11440	COLLIER 50 M/M. ½"
22	* 60618	TAMPON PH 7,0 50 M/L. (VERT)	26	* 28679	COLLIER 63 M/M. ½"
23	* 60633	SOLUTION CALIBRAGE 470 MV	27	71124	CONTROLEUR DE DEBIT
24	* R-061	RECHANGE ÉLECTRODE DT-7	28	* R0819800	SONDE PH P19 AVEC 3 M DE CÂBLE BNC
24	* R-062	RECHANGE ÉLECTRODE DT-10/12	29	* R0819900	SONDE REDOX P19 AVEC 3 M DE CÂBLE E
24	* R-063	RECHANGE ÉLECTRODE DT-21	30	* 74493	PORTE-SONDES
24	* R-064	RECHANGE ÉLECTRODE DT-30	31	* 70054	POMPE PÉRISTALTIQUE 1,5-1,5 230V

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197**


DESCRIPTION: **SYSTÈME ÉLECTROLYSE EXPERT**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
4	* 4408040287	POUR: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	POUR: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	POUR: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	POUR: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	POUR: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	POUR: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	POUR: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	POUR: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	POUR: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	POUR: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	POUR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	POUR: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	POUR: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	POUR: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	POUR: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	POUR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	POUR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	POUR: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	POUR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	POUR: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	POUR: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	POUR: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	POUR: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	POUR: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	POUR: Ø50
26	* 28679	POUR: Ø63
28	* R0819800	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	POUR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	POUR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

CODE 74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197

DESCRIPTION: EXPERT ELECTROLYSIS SYSTEM

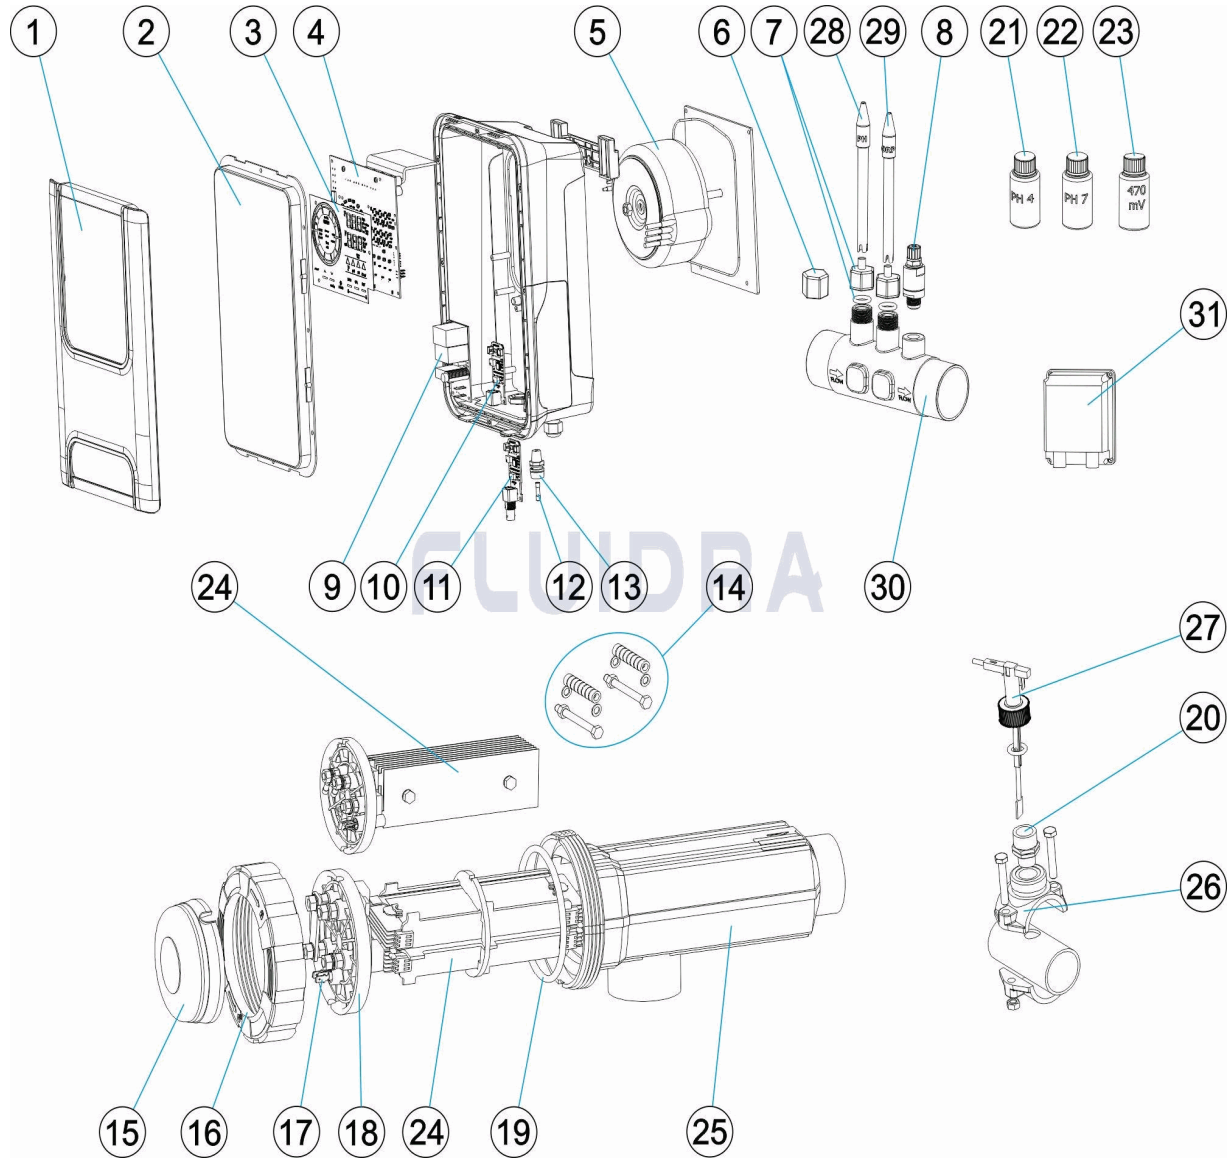

ENGLISH

POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY	POS	CODE	DESCRIPTION	QUANTITY
1	4408040526	FRONT FRAME		8	* 4408040068	PH-MINUS INJECTION VALVE 3/8"	
2	4408060156	BLACK FRONT COVER		9	4408040292	PBA FILTER CONTROL	
3	4408040525	EXPERT KEYPAD		10	* 4408040365	PBA CONTROL ORP	
4	* 4408040287	POWER CARD SMN-7		11	* 4408040293	PBA CONTROL PH	
4	* 4408040288	POWER CARD SMN-12		12	* 4408041112	FUSE 1A	
4	* 4408040289	POWER CARD SMN-21		12	* 4408041113	FUSE 2A	
4	* 4408040290	POWER CARD SMN-30		12	* 4408041114	FUSE 3A	
4	* 4408040291	POWER CARD SMN-40		12	* 4408041204	FUSE 4A	
5	* 4408040265	POWER TRANSFORMER 110 VA		13	4408040523	FUSE HOLDER 5X20	
5	* 4408040266	POWER TRANSFORMER 190 VA		14	* 4408040073	ELECTRODE FIXING KIT	
5	* 4408040267	POWER TRANSFORMER 230 VA		15	4408040527	CONTACT PROTECTION	
5	* 4408040268	POWER TRANSFORMER 340 VA		16	4408040271	CELL THREADED RING	

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIPTION: **EXPERT ELECTROLYSIS SYSTEM**

5	* 4408040269	POWER TRANSFORMER 440 VA	17	4408060158	TEMPERATURE SENSOR
6	* 4408060121	BLACK OBTURATING PLUG + GASKET	18	* 4408040076	TC ELECTRODE HOLDER
7	* 4408060116	SENSOR LOCKING COLLAR + SEAL	18	* 4408040272	BIP ELECTRODE HOLDER
19	4408040510	CELL EPDM GASKET	24	* R-065	DT-40 ELECTRODE SPARE
20	4408060059	M-M ¼ ½" REDUCTION SOCKET	25	57655	ELECTRODE CELL
21	* 60632	CALIBRATION SOLUTION PH 4,0 50 ML. (RE	26	* 11440	CLAMP SADDLE 50 M/M. ½"
22	* 60618	CALIBRATION SOLUTION PH 7,0 50 ML. (G	26	* 28679	CLAMP SADDLE 63 M/M. ½"
23	* 60633	CALIBRATION SOLUTION ORP 470 MV	27	71124	WATER FLOW SWITCH
24	* R-061	DT-7 ELECTRODE SPARE	28	* R0819800	PH SENSOR P19 WITH 3 M BNC CABLE KIT
24	* R-062	DT-10/12 ELECTRODE SPARE	29	* R0819900	ORP SENSOR P19 WITH 3 M BNC CABLE KI
24	* R-063	DT-21 ELECTRODE SPARE	30	* 74493	SENSOR HOLDER
24	* R-064	DT-30 ELECTRODE SPARE	31	* 70054	PERISTALTIC PUMP 1,5-1,5 230V

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**


DESCRIPTION: **EXPERT ELECTROLYSIS SYSTEM**

OBSERVATIONS

POS	CODE	OBSERVATIONS
4	* 4408040287	FOR: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	FOR: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	FOR: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	FOR: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	FOR: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	FOR: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	FOR: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	FOR: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	FOR: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	FOR: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	FOR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	FOR: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	FOR: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	FOR: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	FOR: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	FOR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	FOR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	FOR: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	FOR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	FOR: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	FOR: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	FOR: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	FOR: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	FOR: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	FOR: Ø50
26	* 28679	FOR: Ø63
28	* R0819800	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	FOR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	FOR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

CODICE 74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197

DESCRIZIONE: SISTEMA ELECTROLISI EXPERT

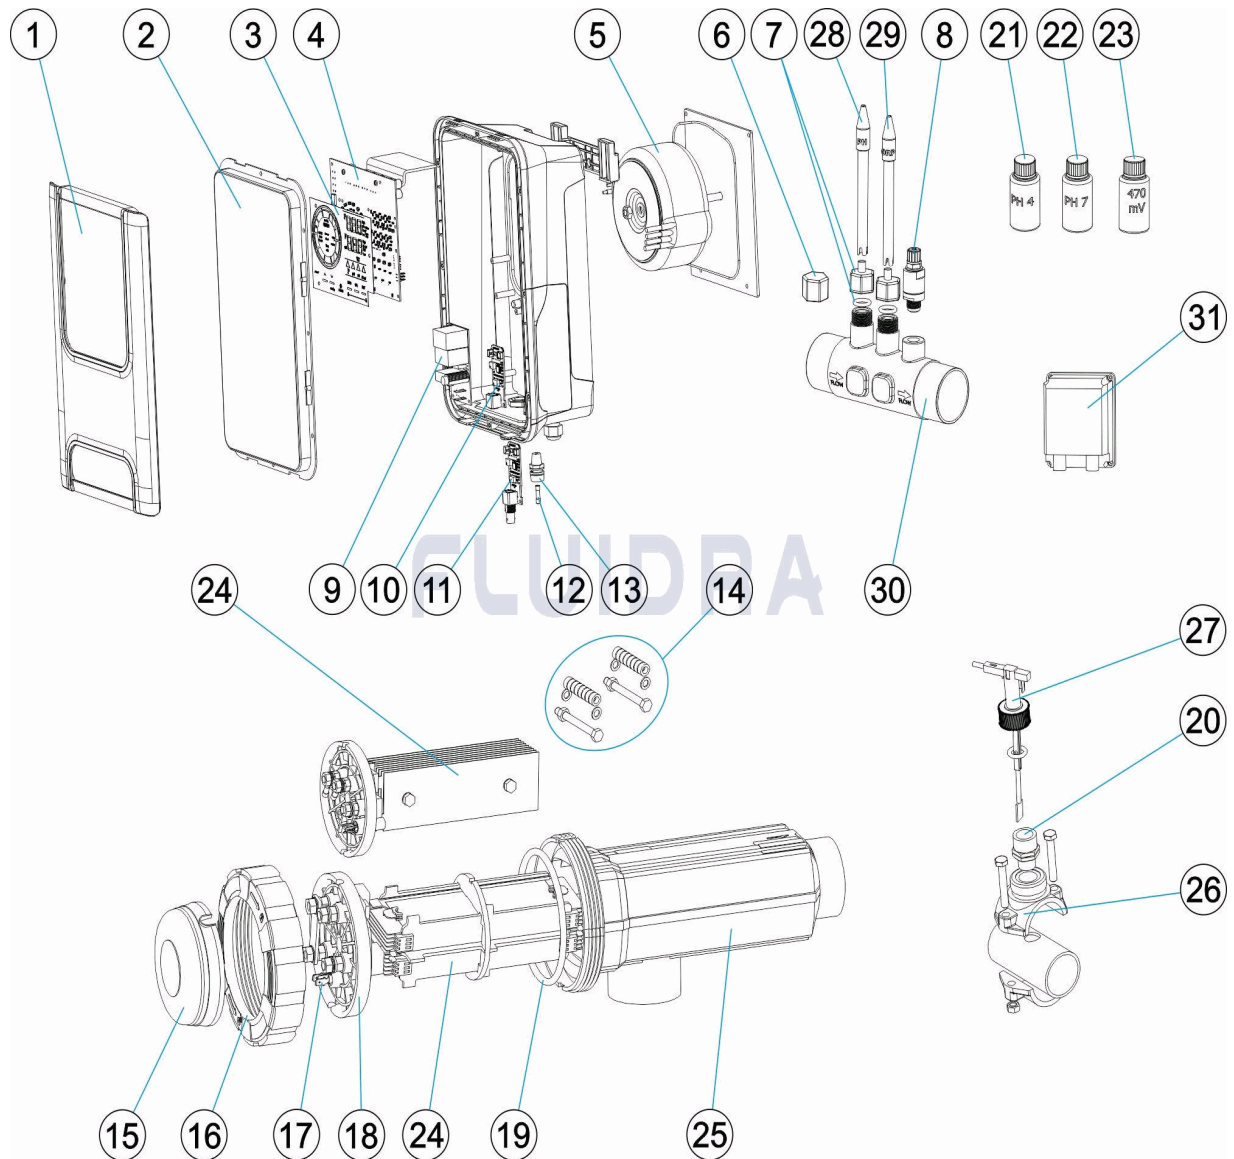

ITALIANO

POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'	POS	CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1	4408040526	CORNICE FRONTALE		8	* 4408040068	VALVOLA INIEZIONE PH-MINUS 3/8"	
2	4408060156	COPERCHIO ANTERIORE NERO		9	4408040292	PBA FILTRO	
3	4408040525	TASTIERA EXPERT		10	* 4408040365	PBA ORP	
4	* 4408040287	CARTA POTENZA SMN-7		11	* 4408040293	PBA PH	
4	* 4408040288	CARTA POTENZA SMN-12		12	* 4408041112	FUSIVILE 1A	
4	* 4408040289	CARTA POTENZA SMN-21		12	* 4408041113	FUSIVILE 2A	
4	* 4408040290	CARTA POTENZA SMN-30		12	* 4408041114	FUSIVILE 3A	
4	* 4408040291	CARTA POTENZA SMN-40		12	* 4408041204	FUSIVILE 4A	
5	* 4408040265	TRANSFORMATORE POTENZA 110 VA		13	4408040523	PORTAFUSIBILI 5X20 CORPO	
5	* 4408040266	TRANSFORMATORE POTENZA 190 VA		14	* 4408040073	ELETTRODI KIT ANCORAGGIO	
5	* 4408040267	TRANSFORMATORE POTENZA 230 VA		15	4408040527	PROTECTORE CONTATTI	
5	* 4408040268	TRANSFORMATORE POTENZA 340 VA		16	4408040271	ANELLO FILETTATO CELLA	

* SI FACCIA RIFERIMENTO AL FOGLIO DELLE OSSERVAZIONI

CODICE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIZIONE: **SISTEMA ELECTROLISI EXPERT**

5	* 4408040269	TRANSFORMATORE POTENZA 440 VA	17	4408060158	SENSORE DI TEMPERATURA
6	* 4408060121	TAPPO NERO PICCOLO + GUARNIZIONE	18	* 4408040076	ELETTRODI DI RICAMBIO RICHIESTA SOST
7	* 4408060116	ANELLO BLOCCAGGIO SONDA + GUARNIZ	18	* 4408040272	ELETTRODI DI RICAMBIO SOSTEGNO BIP
19	4408040510	GUARNICIONE COPERCHIO CELLA	24	* R-065	RECAMBIO ELETTRODO DT-40
20	4408060059	RIDUZIONE M-M 3/4 1/2"	25	57655	CELLA PORTAELETTRODI
21	* 60632	SOLUCIONE TAMPONE PH 4,0 50 ML. (ROS	26	* 11440	COLLARE 50 M/M. ½"
22	* 60618	SOLUCIONE TAMPONE PH 7,0 50 ML. (VEF	26	* 28679	COLLARE 63 M/M. ½"
23	* 60633	SOLUCIONE CALIBRAZIONE 470MV.	27	71124	FLUSSOSTATO
24	* R-061	RECAMBIO ELETTRODO DT-7	28	* R0819800	PH SENSOR TNG
24	* R-062	RECAMBIO ELETTRODO DT-10/12	29	* R0819900	ORP SENSOR TNG
24	* R-063	RECAMBIO ELETTRODO DT-21	30	* 74493	PORTA-SONDE
24	* R-064	RECAMBIO ELETTRODO DT-30	31	* 70054	POMPA PERISTALTICA 1,5-1,5 230V

CODICE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**


DESCRIZIONE: SISTEMA ELECTROLISI EXPERT

OSSERVAZIONI

POS	CODICE	OSSERVAZIONI
4	* 4408040287	PER: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	PER: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	PER: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	PER: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	PER: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	PER: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	PER: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	PER: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	PER: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	PER: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	PER: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	PER: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	PER: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	PER: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	PER: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	PER: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	PER: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	PER: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	PER: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	PER: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	PER: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	PER: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	PER: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	PER: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	PER: Ø50
26	* 28679	PER: Ø63
28	* R0819800	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	PER: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	PER: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

BESCHREIBUNG: **ELEKTROLYTSYSTEM EXPERT**

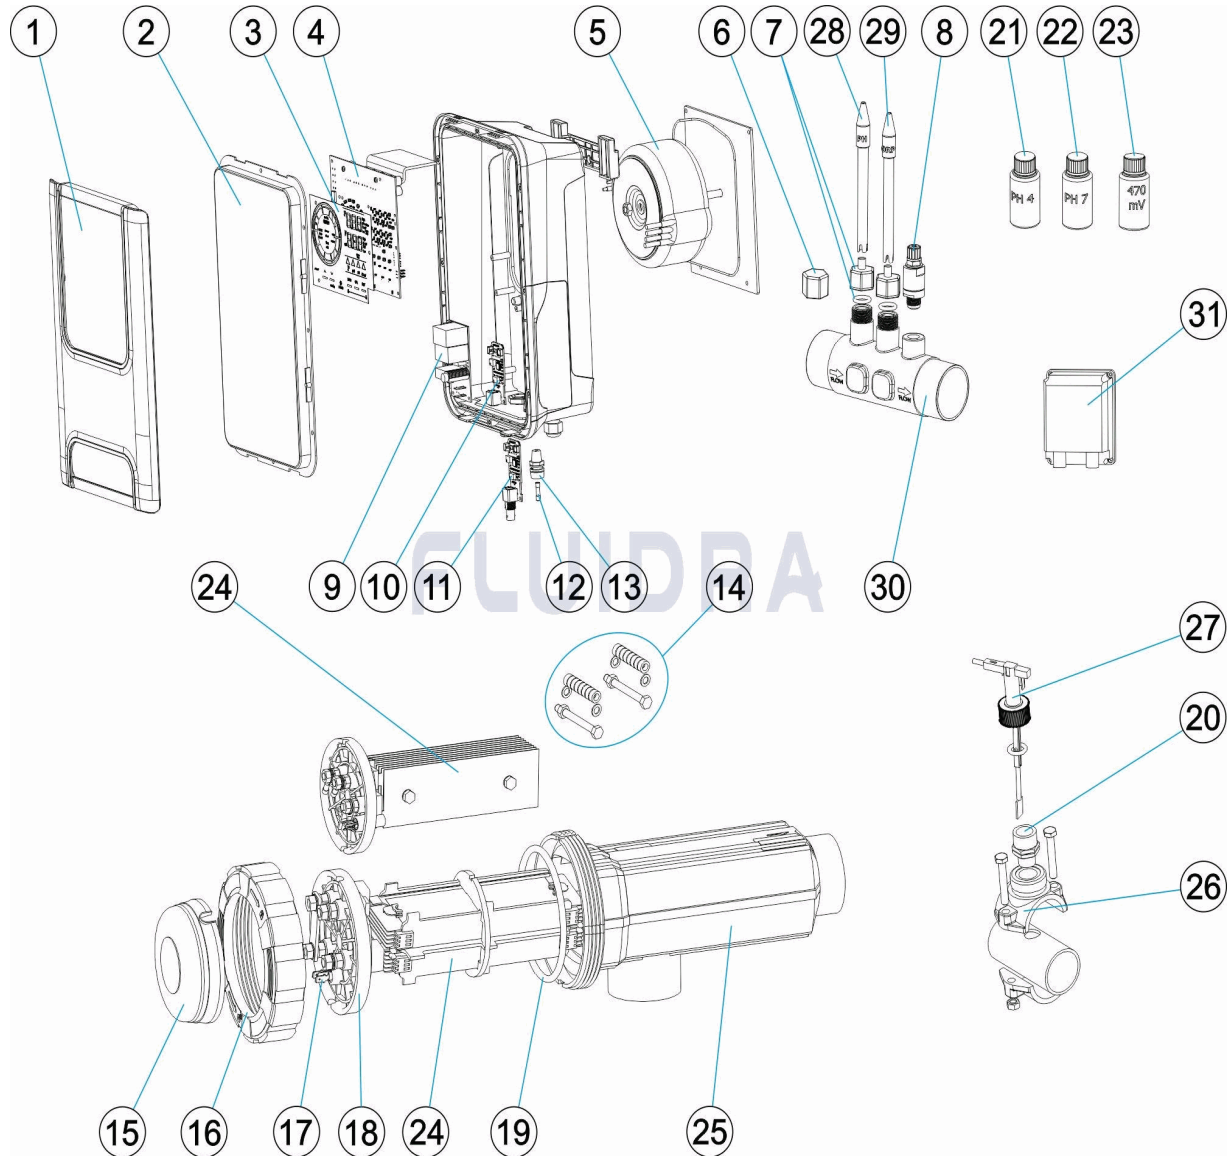

DEUTSCH

POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE	POS	CODE	BESCHREIBUNG	MENGE
1	4408040526	FRONTALRAHMEN		8	* 4408040068	INJEKTORVENTIL PH-MINUS 3/8"	
2	4408060156	SCHWARZE FRONTDECKEL		9	4408040292	PBA FILTERSTEUERUNG	
3	4408040525	TASTATUR EXPERT		10	* 4408040365	PBA STEUERUNG ORP	
4	* 4408040287	LEISTUNGSPLATINE SMN-7		11	* 4408040293	PBA STEUERUNG PH	
4	* 4408040288	LEISTUNGSPLATINE SMN-12		12	* 4408041112	SICHERUNG 1 A	
4	* 4408040289	LEISTUNGSPLATINE SMN-21		12	* 4408041113	SICHERUNG 2 A	
4	* 4408040290	LEISTUNGSPLATINE SMN-30		12	* 4408041114	SICHERUNG 3 A	
4	* 4408040291	LEISTUNGSPLATINE SMN-40		12	* 4408041204	SICHERUNG 4 A	
5	* 4408040265	TRAFO 110 VA		13	4408040523	SICHERUNGSSITZ 5 X 20 RAHMEN	
5	* 4408040266	TRAFO 190 VA		14	* 4408040073	KIT VERANKERUNG ELEKTRODEN	
5	* 4408040267	TRAFO 230 VA		15	4408040527	KONTAKTSCHUTZ	
5	* 4408040268	TRAFO 340 VA		16	4408040271	GEWINDERING ZELLE	

* SIEHE ANMERKUNGSBLATT

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

BESCHREIBUNG: **ELEKTROLYTSYSTEM EXPERT**

5	* 4408040269	TRAFO 440 VA	17	4408060158	TEMPERATURFÜHLER
6	* 4408060121	STOPFEN SCHWARZ VERSCHLUSS UND C	18	* 4408040076	HALTERUNG ELEKTRODE OFFEN TC
7	* 4408060116	SONDENVERRIEGELUNGSRING + DICHTU	18	* 4408040272	HALTERUNG ELEKTRODE BIP
19	4408040510	DICHTUNG GEHÄUSE EPDM	24	* R-065	ERSATZTEIL ELEKTRODE DT-40
20	4408060059	REDUZIERSTÜCK M M 3/4 1/2"	25	57655	ELEKTRODENZELLE
21	* 60632	PUFFER PH 4,0 50 ML (ROT)	26	* 11440	ANBORSHELLEN 50 MM. ½"
22	* 60618	PUFFER PH 7,0 50 M/L (GRÜN)	26	* 28679	ANBORSHELLEN 63 MM. ½"
23	* 60633	KALIBRIERLÖSUNG 47 0MV	27	71124	DURCHFLUSSMESSER
24	* R-061	ERSATZTEIL ELEKTRODE DT-7	28	* R0819800	PH-SENSOR P19
24	* R-062	ERSATZTEIL ELEKTRODE DT-10/12	29	* R0819900	ORP SENSOR TNG
24	* R-063	ERSATZTEIL ELEKTRODE DT-21	30	* 74493	SONDENHALTERUNG
24	* R-064	ERSATZTEIL ELEKTRODE DT-30	31	* 70054	PERISTALTIKPUMPE P1,5-1,5 230V

CODE **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**


BESCHREIBUNG: **ELEKTROLYTSYSTEM EXPERT**

HINWEISE

POS	CODE	HINWEISE
4	* 4408040287	FÜR: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	FÜR: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	FÜR: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	FÜR: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	FÜR: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	FÜR: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	FÜR: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	FÜR: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	FÜR: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	FÜR: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	FÜR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	FÜR: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	FÜR: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	FÜR: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	FÜR: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	FÜR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	FÜR: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	FÜR: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	FÜR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	FÜR: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	FÜR: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	FÜR: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	FÜR: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	FÜR: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	FÜR: Ø50
26	* 28679	FÜR: Ø63
28	* R0819800	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	FÜR: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	FÜR: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

CODIGO 74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197

DESCRIÇÃO: SISTEMA ELECTROLISE EXPERT

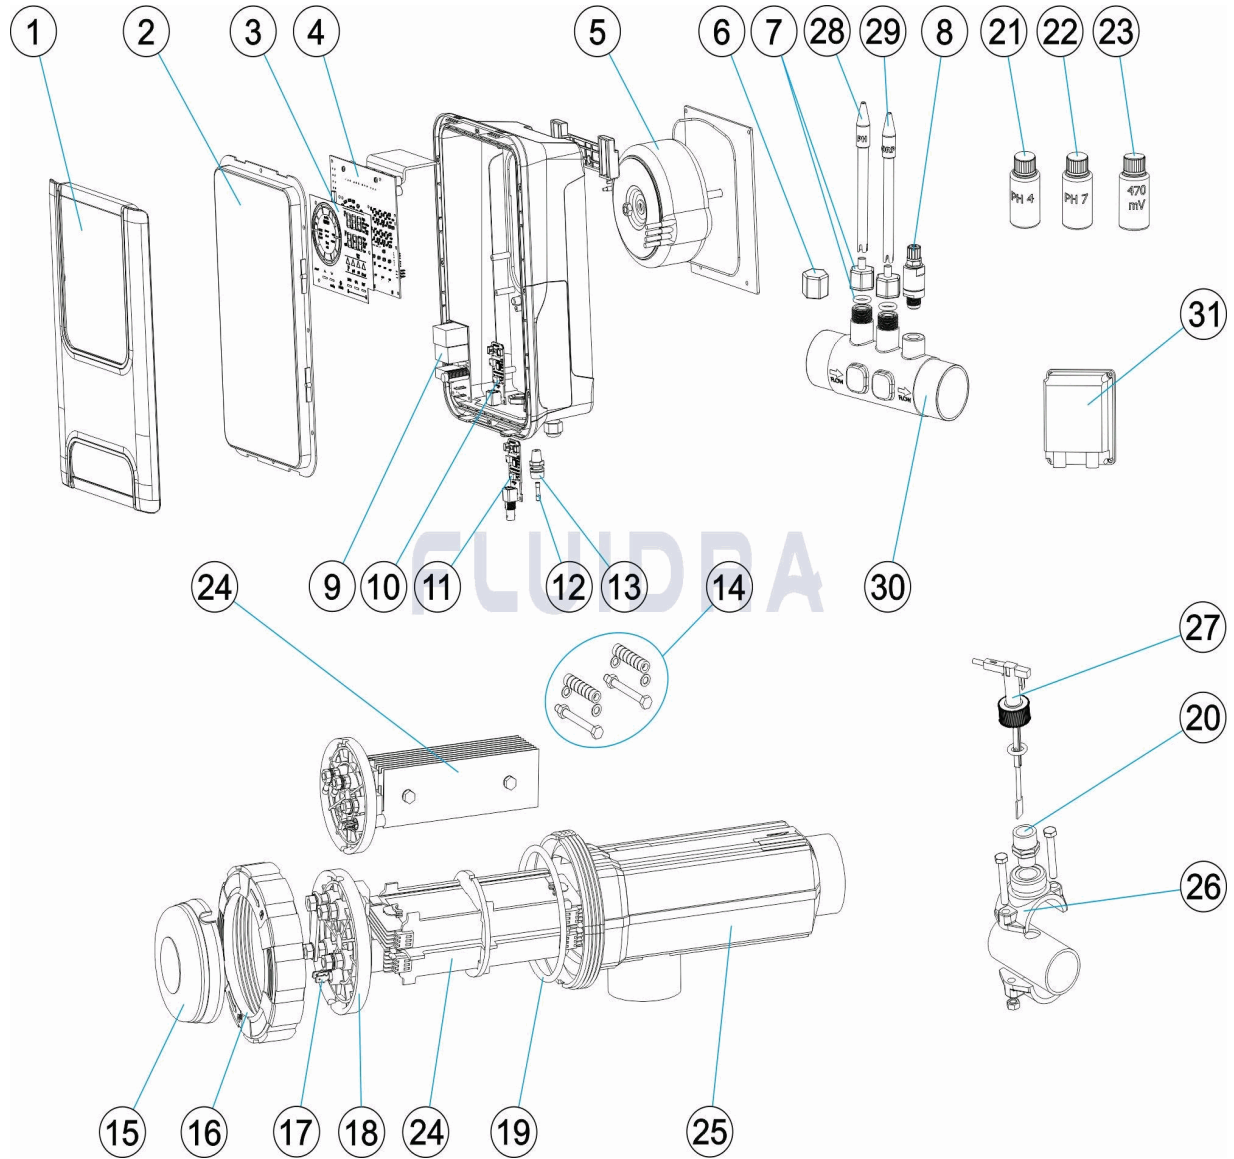

PORTUGUES

POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE	POS	CODIGO	DESCRIÇÃO	JANTIDADE
1	4408040526	CAIXILHO FRONTAL		8	* 4408040068	VALVOLA INJEÇÃO PH-MINUS 3/8"	
2	4408060156	TAMPA FRONTAL PRETA		9	4408040292	PBA FILTRO CONTROL	
3	4408040525	TECLADO EXPERT		10	* 4408040365	PBA CONTROL ORP	
4	* 4408040287	TARJETA POTÊNCIA SMN-7		11	* 4408040293	PBA CONTROL PH	
4	* 4408040288	TARJETA POTÊNCIA SMN-12		12	* 4408041112	FUSÍVEL 1A	
4	* 4408040289	TARJETA POTÊNCIA SMN-21		12	* 4408041113	FUSÍVEL 2A	
4	* 4408040290	TARJETA POTÊNCIA SMN-30		12	* 4408041114	FUSÍVEL 3A	
4	* 4408040291	TARJETA POTÊNCIA SMN-40		12	* 4408041204	FUSÍVEL 4A	
5	* 4408040265	TRANSFORMADOR POTÊNCIA 110VA		13	4408040523	PORTAFUSIVEIS 5X20 CHASIS	
5	* 4408040266	TRANSFORMADOR POTÊNCIA 190VA		14	* 4408040073	KIT ÂNCORA ELETRODOS KIT	
5	* 4408040267	TRANSFORMADOR POTÊNCIA 230VA		15	4408040527	PROTECTOR CONTACTOS	
5	* 4408040268	TRANSFORMADOR POTÊNCIA 340VA		16	4408040271	ANEL ROSQUEADO CÉLULA	

*** VEJA A FICHA DE OBSERVAÇÕES**

CODIGO **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIÇÃO: SISTEMA ELECTRÓLISE EXPERT

5	* 4408040269	TRANSFORMADOR POTÊNCIA 440VA	17	4408060158	SENSOR DE TEMPERATURA
6	* 4408060121	TAMPÃO PRETO OBTURADOR + JUNTA	18	* 4408040076	ELETRODOS DE REPOSIÇÃO APOIO ABER
7	* 4408060116	ANEL DE BLOQUEIO DA Sonda + JUNTA	18	* 4408040272	ELETRODOS DE REPOSIÇÃO APOIO BIP
19	4408040510	JUNTA EPDM COPO	24	* R-065	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO DT-40
20	4408060059	REDUÇÃO M-M 3/4 1/2"	25	57655	VASO PORTA-ELECTRODOS
21	* 60632	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,0 50 ML. (VERMEI	26	* 11440	COLARINHO 50 M/M. ½"
22	* 60618	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,0 50 ML. (VERDE	26	* 28679	COLARINHO 63 M/M. ½"
23	* 60633	SOLUÇÃO TAMPÃO 470 MV	27	71124	FLUXO-ESTATO
24	* R-061	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO DT-7	28	* R0819800	PH SENSOR TNG
24	* R-062	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO DT-10/12	29	* R0819900	ORP SENSOR TNG
24	* R-063	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO DT-21	30	* 74493	PORTA-SONDAS
24	* R-064	SOBRESSALENTE ELÉCTRODO DT-30	31	* 70054	BOMBA PERISTÁLTICA 1,5-1,5 230V

CODIGO **74183, 74184, 74185, 74186, 74187, 74188, 74189, 74190, 74191, 74192,
74193, 74194, 74195, 74196, 74197**

DESCRIÇÃO: SISTEMA ELECTRÓLISE EXPERT

OBSERVAÇÕES

POS	CODIGO	OBSERVAÇÕES
4	* 4408040287	PARA: 74183, 74188, 74193
4	* 4408040288	PARA: 74184, 74189, 74194
4	* 4408040289	PARA: 74185, 74190, 74195
4	* 4408040290	PARA: 74186, 74191, 74196
4	* 4408040291	PARA: 74187, 74192, 74197
5	* 4408040265	PARA: 74183, 74188, 74193
5	* 4408040266	PARA: 74184, 74189, 74194
5	* 4408040267	PARA: 74185, 74190, 74195
5	* 4408040268	PARA: 74186, 74191, 74196
5	* 4408040269	PARA: 74187, 74192, 74197
6	* 4408060121	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192
7	* 4408060116	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
8	* 4408040068	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
10	* 4408040365	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
11	* 4408040293	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
12	* 4408041112	PARA: 74183, 74188, 74193
12	* 4408041113	PARA: 74184, 74185, 74189, 74190, 74194, 74195
12	* 4408041114	PARA: 74186, 74191, 74196
12	* 4408041204	PARA: 74187, 74192, 74197
14	* 4408040073	PARA: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040076	PARA: 74183, 74184, 74188, 74189, 74193, 74194
18	* 4408040272	PARA: 74185, 74186, 74187, 74190, 74191, 74192, 74195, 74196, 74197
21	* 60632	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
22	* 60618	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
23	* 60633	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
24	* R-061	PARA: 74183, 74188, 74193
24	* R-062	PARA: 74184, 74189, 74194
24	* R-063	PARA: 74185, 74190, 74195
24	* R-064	PARA: 74186, 74191, 74196
24	* R-065	PARA: 74187, 74192, 74197
26	* 11440	PARA: Ø50
26	* 28679	PARA: Ø63
28	* R0819800	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
29	* R0819900	PARA: 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
30	* 74493	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197
31	* 70054	PARA: 74188, 74189, 74190, 74191, 74192, 74193, 74194, 74195, 74196, 74197